GL□□
AN10

微圧計

Low Pressure Gauges

概　要

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。



特　長

- **標準精度：±1.5%F.S.（オプション±1.0%F.S.）で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。**
- **シンプルな構造の製品であり、取扱いが容易です。**

※AN10は精度：±2.0%F.S.


圧力計を選定される際は、性能を十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
　定圧力の場合：圧力レンジの最大値の3/4以下
　変動圧力の場合：圧力レンジの最大値の2/3以下
また記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

圧力エレメント

主として、カプセル式、ベローズ式の２方式があり、いずれも、圧力エレメントであるカプセルあるいはベローズの圧力による変位を利用するものです。これらの変位は、精密内機を用いた拡大機構により拡大され、指針に伝えられます。尚、ケースは気温の変化による指示圧力に影響を及ぼす内圧をさけるため、通気する構造となっております。


カプセル式

右図のように、波形の円形金属板を２枚合わせたもので、その内部に圧力を加えて、それによる変位を利用する方法です。



ベローズ式

右図のように、蛇腹状をした円筒形でその一端を閉じ、他端から内部に圧力を加えて、それによる変位を利用する方法です。



※AN10はブルドン管式となります。

製作仕様1

測定流体：
気　体

大きさ：
φ64　（モデル：GL17）
φ75　（モデル：GL13, GL19, AN10）
φ100（モデル：GL10, GL15, GL20, GL25）
φ150（モデル：GL21, GL26）
φ200（モデル：GL22, GL23, GL27, GL28）

形　状：
立　形‥‥ A枠　B枠
埋込形‥‥ D枠
直結形　取付金具　取付穴

接続ねじ：
R1/4、G3/8B、R3/8、3/8NPT、G1/2B、R1/2、1/2NPT（モデルによる）

使用温度範囲：
－５℃～40℃

精　度：
±1.5%F.S.
ご指定により±1.0%F.S.も製作致します。
※AN10は精度：±2.0%F.S.

ケース構造：
IP22相当

質　量：
約0.3kg～約3.5kg
※詳細は 製作仕様３をご参照ください。

製作仕様2

圧力レンジ・接ガス部材質・最小目盛：

φ64、φ75 カプセル式

圧力レンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質 GL17-671 GL13-1□1 GL19-231	接続部材質
正圧	負圧	連成			
0～5	−5～0	−2～3	0.2	りん青銅	C3604 但し、GL17-671・GL19-231：CAC203
		−3～2			
0～7	−7～0	−2～5	0.2		
		−5～2			
0～10	−10～0	−5～5	0.5		
0～15	−15～0	−5～10	0.5		
		−10～5			

※エレメントと接続部のシールにOリング（NBR）を使用しています。

φ75 ブルドン管式

圧力レンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質 AN10-1□1	接続部材質
正圧	負圧	連成			
0～20	−20～0	−10～10	1	C6872	C3771
0～30	−30～0	−10～20	1		
		−20～10			
0～40	−40～0	−10～30	2		
		−30～10			
		−20～20			
0～50	−50～0	−20～30	2		
		−30～20			

φ100 カプセル式／φ200 ベローズ式

圧力レンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質		接続部材質	
				φ100 カプセル式	φ200 ベローズ式	φ100 カプセル式	φ200 ベローズ式
				一般用途	耐食用途	一般用途	耐食用途
正圧	負圧	連成		GL10-2□1、GL15-1□1	GL22-2□3、GL27-1□3		
0～2	−2～0	−1～1	0.05	りん青銅	SUS316L	GL10：C3604 GL15：CAC203	SUS316
0～3	−3～0	−1～2	0.1				
		−2～1					

※φ100カプセル式のエレメントと接続部のシールにOリング（NBR）を使用しています。

φ100・150・200 ベローズ式

圧力レンジ kPa			最小目盛 kPa	エレメント材質						接続部材質	
				φ100		φ150		φ200		一般用途	耐食用途
				一般用途	耐食用途	一般用途	耐食用途	一般用途	耐食用途		
正圧	負圧	連成		GL20-2□1 GL25-1□1	GL20-2□3 GL25-1□3	GL21-2□1 GL26-1□1	GL21-2□3 GL26-1□3	GL23-2□1 GL28-1□1	GL23-2□3 GL28-1□3		
0～4	−4～0	−1～3	0.1	りん青銅	SUS316L	りん青銅	SUS316L	りん青銅	SUS316L	CAC203 但し、GL23-2□1：C3604	SCS14 但し、GL26-1□3・GL23-2□3・GL28-1□3：SUS316
		−3～1									
		−2～2									
0～5	−5～0	−1～4	0.1								
		−4～1									
		−2～3									
		−3～2									
0～7	−7～0	−2～5	0.2								
		−5～2									
		−3～4									
		−4～3									
0～10	−10～0	−5～5	0.2								
0～15	−15～0	−5～10	0.5								
		−10～5									
0～20	−20～0	−10～10	0.5								
0～30	−30～0	−10～20	1								
		−20～10									
		−15～15									

製作仕様3

ケース材質・外装色・エレメント・ガラス：


大きさ		形　番	枠形状	ケース材質・外装色				エレメント	圧力レンジ（真空・連成含）	接続ねじ	ガラス	質量（kg）
				材　質		色						
				内　枠	外　枠	内　枠	外　枠					
φ64		GL17−671	D ツバなし	SPCC	SPCC	銀、Crメッキ		カプセル	0〜5kPa→0〜15kPa	R1/4	無機（標準）又は、有機	約0.3
φ75	低圧	GL13−1□1	A	ナイロン	SUS430	黒	生地	カプセル	0〜5kPa→0〜15kPa	G3/8B他	無機（標準）又は、有機	約0.5
		GL19−231	D 取付穴	SPCC	SPCC	銀、Crメッキ		カプセル	0〜5kPa→0〜15kPa	G3/8B	無機（標準）又は、有機	約0.35
	高圧	AN10−1□1	A	ナイロン	SUS430	黒	生地	ブルドン管	0〜20kPa→0〜50kPa	G3/8B他	無機（標準）又は、有機	約0.35
φ100	低圧	GL10−2□1	B 取付穴	ADC12	ADC12	黒		カプセル	0〜2、3kPa	G3/8B他	無機（標準）又は、有機、他	約0.6
		GL15−1□1	D 取付金具	アルミ合金								約0.75
	高圧	GL20−2□□	B 取付穴	ADC12				ベローズ	0〜4kPa→0〜30kPa			約0.7
		GL25−1□□	D 取付金具									約1.5
φ150		GL21−2□□	B 取付穴	アルミ合金								約3
		GL26−1□□	D 取付金具									約3.5
φ200	低圧	GL22−2□3	B 取付穴	アルミ合金					0〜2、3kPa			約3
		GL27−1□3	D 取付金具									約3.5
	高圧	GL23−2□□	B 取付穴						0〜4kPa→0〜30kPa			約3
		GL28−1□□	D 取付金具									約2
		GL28−2□□	D 取付穴									約2

外形寸法1

単位：mm

φ64（D枠、直結形）

カプセル式

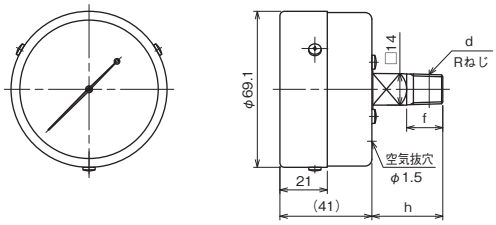


GL17−671

大きさ	形番・対応モデル	接続ねじ	接続ねじ部寸法		
		d	f	h	n
φ64	GL17−671	R1/4	16	31.4	−
φ75	GL19−231	G3/8B	18	33	
	GL13−1□1	G3/8B, R3/8, 3/8NPT		70	
	AN10−1□1				
φ100	GL10−2□1			82	
	GL15−1□1			33	
	GL20−2□□	G3/8B, R3/8, 3/8NPT		82	
		G1/2B, R1/2, 1/2NPT	20	84	
φ150	GL25−1□□	G3/8B, R3/8, 3/8NPT	18	30	35
	GL21−2□□			110	−
	GL26−1□□			30	45
φ200	GL22−2□3			150	−
	GL23−2□□				
	GL27−1□3			30	70
	GL28−1□□				45
	GL28−2□□				


φ75（A枠）

カプセル式・ブルドン管式

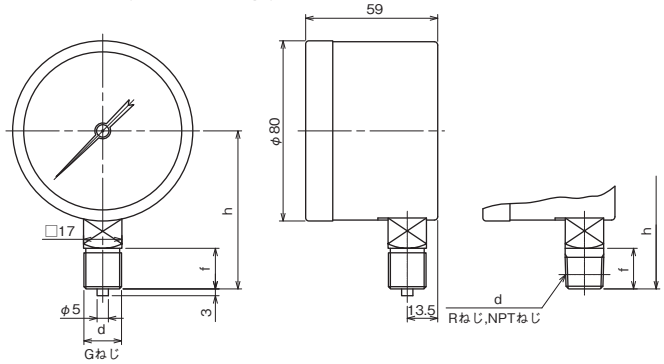

GL13−1□1
AN10−1□1

φ75（D枠 取付穴）

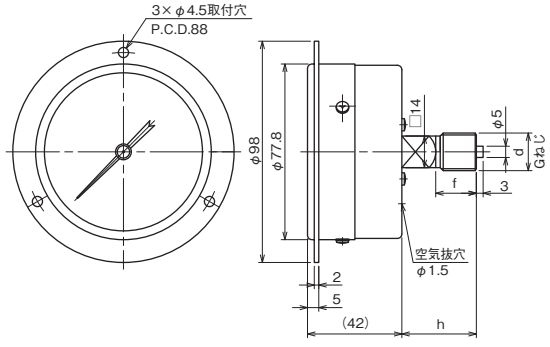


GL19−231

外形寸法2


単位：mm

φ100

カプセル式

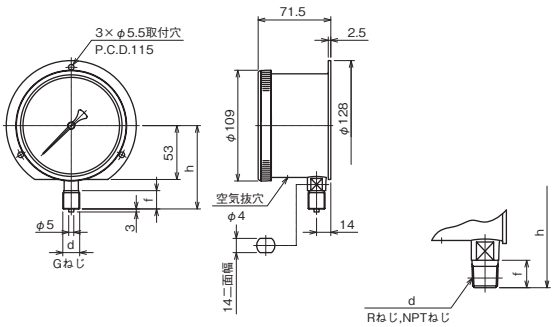


GL10−2□1

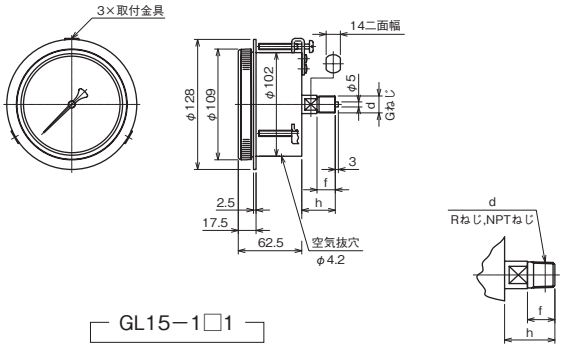


GL15−1□1

φ100

ベローズ式

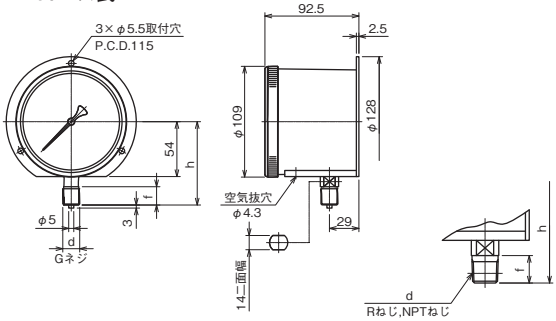


GL20−2□□

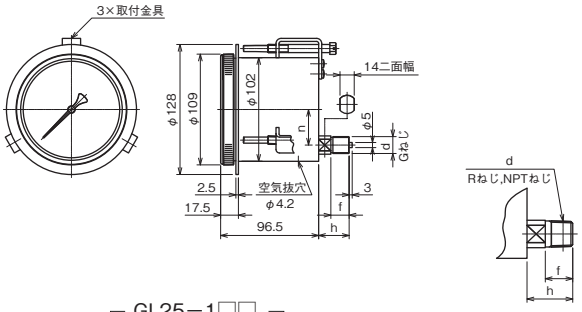


GL25−1□□

φ150

ベローズ式

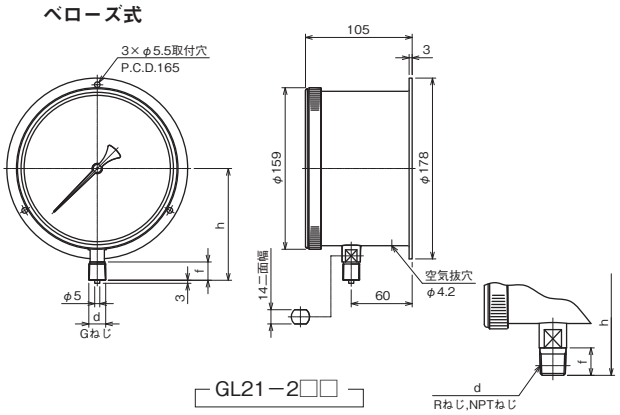


GL21−2□□

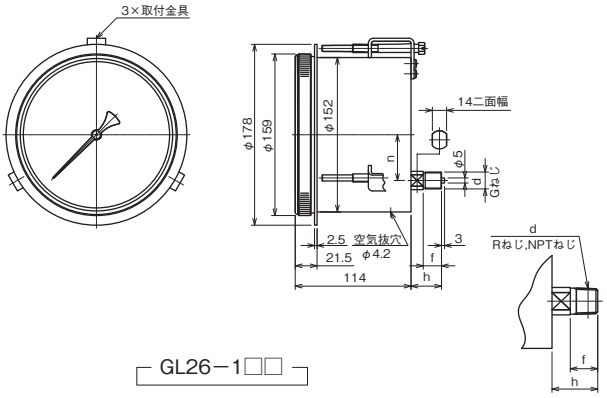


GL26−1□□

φ200

ベローズ式

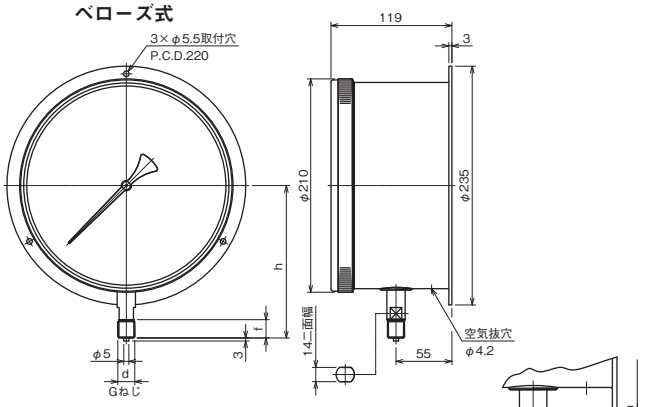

GL22−2□3
GL23−2□□

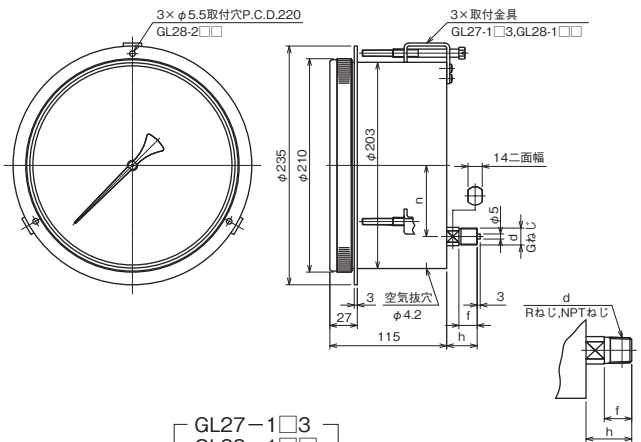

GL27−1□3
GL28−1□□
GL28−2□□

形番構成 1

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G L 1 7	—	6	7	1	—			0				×	×	×	×	×	
微圧計（カプセル式） φ64 D枠 直結形		①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
①形状		埋込形		
	6	D枠（直結形）		
②接続ねじ	7	R1/4		
③接ガス部材質	1	カプセル式 「製作仕様２」をご参照ください。		
④圧力レンジ（kPa）	2	0～5、7、10、15		
	6	−5、−7、−10、−15～0		
	9	連成計　（「製作仕様２」をご参照ください。）		
⑤精度	0	標準（± 1.5% F.S.）		
	3	± 1.0% F.S.		
⑥指針	0	標準		
⑦ガラス	0	無機ガラス（標準）		
	1	有機ガラス		
⑧処理	0	ナシ		
	1	禁油処理		
	2	禁水処理		
	3	禁油・禁水処理		
⑨その他付加仕様	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」		
⑮ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（１個１部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成2

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G L 1 3	—	1		1	—			0				×	×	×	×	×	
微圧計（カプセル式）φ75 A枠		①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
①形状		立形		
	1	A枠		
②接続ねじ	3	G3/8B		
	G	R3/8		
	L	3/8NPT		
	9	その他指定		
③接ガス部材質	1	カプセル式 「製作仕様2」をご参照ください。		
④圧力レンジ（kPa）	2	0～5、7、10、15		
	6	−5、−7、−10、−15～0		
	9	連成計　（「製作仕様2」をご参照ください。）		
⑤精度	0	標準（± 1.5% F.S.）		
	3	± 1.0% F.S.		
⑥指針	0	標準		
⑦ガラス	0	無機ガラス（標準）		
	1	有機ガラス		
⑧処理	0	ナシ		
	1	禁油処理		
	2	禁水処理		
	3	禁油・禁水処理		
⑨その他付加仕様	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定		
⑮ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成３

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	1	9	—	2	3	1	—			0				×	×	×	×	×	
					①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

微圧計（カプセル式）
φ75 D枠 取付穴

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
①形状		埋込形		
	2	D枠（取付穴）		
②接続ねじ	3	G3/8B		
③接ガス部材質	1	カプセル式 「製作仕様２」をご参照ください。		
④圧力レンジ（kPa）	2	0～5、7、10、15		
	6	−5、−7、−10、−15～0		
	9	連成計　（「製作仕様２」をご参照ください。）		
⑤精度	0	標準（± 1.5% F.S.）		
	3	± 1.0% F.S.		
⑥指針	0	標準		
⑦ガラス	0	無機ガラス（標準）		
	1	有機ガラス		
⑧処理	0	ナシ		
	1	禁油処理		
	2	禁水処理		
	3	禁油・禁水処理		
⑨その他付加仕様	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」		
⑮ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（１個１部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Ｘをご指定ください。

形番構成4

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

A N 1 0	—	1		1	—		0	0				×	×	×	×	×	
微圧計（ブルドン管式）φ75		①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番			選択仕様	付加仕様（オプション）
①形状		立形		
	1	A枠		
②接続ねじ	3	G3/8B		
	G	R3/8		
	L	3/8NPT		
③接ガス部材質	1	ブルドン管式 「製作仕様2」をご参照ください。		
④圧力レンジ（kPa）	3	0～20、30、40、50		
	6	−20、−30、−40、−50～0		
	9	連成計　（「製作仕様2」をご参照ください。）		
⑤精度	0	標準（± 2.0% F.S.）		
⑥指針	0	標準		
⑦ガラス	0	無機ガラス（標準）		
	1	有機ガラス		
⑧処理	0	ナシ		
	1	禁油処理		
	2	禁水処理		
	3	禁油・禁水処理		
⑨その他付加仕様	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定		
⑮ドキュメント	0	ナシ		
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査		

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成５

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	1	□	—	□	□	1	—	□	□	0	□	□	□	×	×	×	×	×	□
微圧計（カプセル式）φ100					①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

形番				選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル		大きさ	枠形状		
	0	φ100	立形：B枠		
	5	φ100	埋込形：D枠		

①形状		立形	埋込形
	1	―――	D枠（取付金具）　GL15
	2	B枠　GL10	―――
②接続ねじ	3	G3/8B	
	G	R3/8	
	9	その他指定	
③接ガス部材質	1	カプセル式 「製作仕様２」をご参照ください。	
④圧力レンジ（kPa）	1	0～2、3	
	5	−2、−3～0	
	9	連成計　（「製作仕様２」をご参照ください。）	
⑤精度	0	標準（± 1.5% F.S.）	
	3	± 1.0% F.S.	
⑥指針	0	標準	
⑦ガラス	0	無機ガラス（標準）	
	1	有機ガラス	
	2	強化ガラス	
	3	無反射ガラス	
	6	曇り止めガラス	
	9	その他指定	
⑧処理	0	ナシ	
	1	禁油処理	
	2	禁水処理	
	3	禁油・禁水処理	
⑨その他付加仕様	0	ナシ	
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定	
⑮ドキュメント	0	ナシ	
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（１個１部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査	

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成6

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	2	□	—	①	②	③	—	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
															×	×	×	×	×	

微圧計（ベローズ式）
φ100

形番				選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル		大きさ	枠形状		
	0	φ100	立形：B枠		
	5	φ100	埋込形：D枠		

①形状	立形	埋込形
1	————	D枠（取付金具）　GL25
2	B枠　GL20	————

②接続ねじ	
3	G3/8B
D	G1/2B
G	R3/8
H	R1/2
L	3/8NPT
M	1/2NPT
9	その他指定

③接ガス部材質		
1	ベローズ式：一般用	
3	ベローズ式：耐食用	「製作仕様2」をご参照ください。

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

④圧力レンジ（kPa）		
1	0～4、5、−4～0、−5～0	耐食用
3	0～4、5、7、10、15、20、30	一般用
4	0～7、10、15、20、30	耐食用
7	−4、−5、−7、−10、−15、−20、−30～0	一般用
8	−7、−10、−15、−20、−30～0	耐食用
9	連成計　（「製作仕様2」をご参照ください。）	

⑤精度	
0	標準（± 1.5% F.S.）
3	± 1.0% F.S.

⑥指針	
0	標準
1	ゼロ調指針（歯車式）
2	ゼロ調指針（バネ式）

⑦ガラス	
0	無機ガラス（標準）
1	有機ガラス
2	強化ガラス
3	無反射ガラス
6	曇り止めガラス
9	その他指定

⑧処理	
0	ナシ
1	禁油処理
2	禁水処理
3	禁油・禁水処理

⑨その他付加仕様	
0	ナシ
1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定

⑮ドキュメント	
0	ナシ
1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成7

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	2	□	—	①	②	③	—	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
微圧計（ベローズ式）φ150															×	×	×	×	×	

形番				選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル		大きさ	枠形状		
	1	φ150	立形：B枠		
	6	φ150	埋込形：D枠		

①形状		立形	埋込形
	1	―――	D枠（取付金具）　GL26
	2	B枠　GL21	―――

②接続ねじ	3	G3/8B
	G	R3/8
	9	その他指定

③接ガス部材質	1	ベローズ式：一般用
	3	ベローズ式：耐食用　「製作仕様2」をご参照ください。

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

④圧力レンジ（kPa）	3	0～4、5、7、10、15、20、30
	7	−4、−5、−7、−10、−15、−20、−30～0
	9	連成計　（「製作仕様2」をご参照ください。）

⑤精度	0	標準（± 1.5% F.S.）
	3	± 1.0% F.S.

⑥指針	0	標準
	1	ゼロ調指針（歯車式）
	2	ゼロ調指針（バネ式）

⑦ガラス	0	無機ガラス（標準）
	1	有機ガラス
	2	強化ガラス
	3	無反射ガラス
	6	曇り止めガラス
	9	その他指定

⑧処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理

⑨その他付加仕様	0	ナシ
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定

⑮ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成8

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	2	□	—	①	②	3	—	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
															×	×	×	×	×	

微圧計（ベローズ式）
φ200

形番				選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル		大きさ	枠形状		
	2	φ200	立形：B枠		
	7	φ200	埋込形：D枠		

①形状	立形	埋込形
1	————	D枠（取付金具）　GL27
2	B枠　GL22	————

②接続ねじ	
3	G3/8B
G	R3/8
9	その他指定

③接ガス部材質		
3	ベローズ式：耐食用	「製作仕様2」をご参照ください。

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

④圧力レンジ（kPa）	
1	0～2、3
2	−2～0、−3～0
9	連成計　（「製作仕様2」をご参照ください。）

⑤精度	
0	標準（± 1.5% F.S.）
3	± 1.0% F.S.

⑥指針	
0	標準
1	ゼロ調指針（歯車式）
2	ゼロ調指針（バネ式）

⑦ガラス	
0	無機ガラス（標準）
1	有機ガラス
2	強化ガラス
3	無反射ガラス
9	その他指定

⑧処理	
0	ナシ
1	禁油処理
2	禁水処理
3	禁油・禁水処理

⑨その他付加仕様	
0	ナシ
1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 目盛指定「注1」、外装指定

⑮ドキュメント	
0	ナシ
1	アリ （ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表（1個1部）、 検査・トレサビリティ証明書、 強度計算書、立会検査

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

形番構成9

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

モデルNo.

G	L	2	□	—	①	②	③	—	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
			微圧計（ベローズ式）φ200												×	×	×	×	×	

形番				選択仕様	付加仕様（オプション）
モデル		大きさ	枠形状		
	3	φ200	立形：B枠		
	8	φ200	埋込形：D枠		

①形状	立形	埋込形
1	————	D枠（取付金具） GL28
2	B枠 GL23	D枠（取付穴） GL28

②接続ねじ	
3	G3/8B
9	その他指定

③接ガス部材質		
1	ベローズ式：一般用	
3	ベローズ式：耐食用	「製作仕様2」をご参照ください。

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。

④圧力レンジ（kPa）	
3	0～4、5、7、10、15、20、30
7	−4、−5、−7、−10、−15、−20、−30～0
9	連成計 （「製作仕様2」をご参照ください。）

⑤精度	
0	標準（± 1.5% F.S.）
3	± 1.0% F.S.

⑥指針	
0	標準
1	ゼロ調指針（歯車式）
2	ゼロ調指針（バネ式）

⑦ガラス	
0	無機ガラス（標準）
1	有機ガラス
2	強化ガラス
3	無反射ガラス
9	その他指定

⑧処理	
0	ナシ
1	禁油処理
2	禁水処理
3	禁油・禁水処理

⑨その他付加仕様	
0	ナシ
1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）目盛指定「注1」、外装指定

⑮ドキュメント	
0	ナシ
1	アリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）提出図、取扱説明書、検査要領書、ミルシート、検査成績表（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査

「製作範囲」
「注1」目盛指定：容量目盛、記入文字、サークル塗り、目盛分割

※仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。